

DIT-300

紅外線溫度計



泰菱有限公司

電話：(02) 2737-5866

HTTP://www.tecpel.com

傳真：(02) 2737-3343

HTTP://www.oka.com.tw



距離與面積比說明

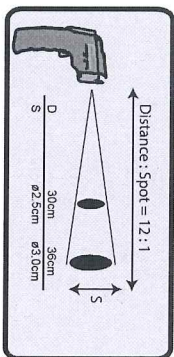


圖 1.

面板符號說明






圖 2.

按鍵說明

- °F：切換顯示攝氏/華氏單位。
 - ：開啟或關閉雷射功能
 - ：開啟或關閉畫面背光功能
1. 低電顯示
 2. 讀值鎖定符號
 3. 雷射符號
 4. 攝氏 / 華氏
 5. 量測數值

產品規格說明

產品規格	
溫度範圍	-50 ~ 500°C
精確度	±2% 或 2°C
解析度	0.1°C
反應時間	≤0.8s
放射率	0.95
D : S 比	12:1
紅外線波長	5 ~ 14 μm
存放溫度	-20 ~ 50°C
電池規格	9V

使用說明與注意事項

1. 使用時請勿直視雷射光!
2. 量測面積會隨與測物距離而有所差異，距離越遠，量測面積將越大。(參考圖 1.)
3. 測量溫度時，將紅外線溫度計瞄準被測目標，然後扣住扳機將立即顯示測量結果，鬆開扳機則保持讀數。
4. 如量測後無任何動作，紅外線溫度計將於30秒後關閉電源
5. 如長時間不使用，應卸除電池。

泰菱公司產品保固內容：

- 商品自購買起，泰菱公司對所販售新機將給予保固一年。
- 新品不良更換，需於7日內更換完畢，商品配件需完整，包含外箱、發票等方可換新。
- 保固產品泰菱公司將提供問題諮詢，電話教學及簡易問題排除說明，但如需人員到府或到場處理，將視情況酌收費用。
- 保固期間一年如遇人為不當操作、消耗性零組件老化等問題，皆屬於保固外處理，泰菱公司將視情況酌收費用或請顧客購買新的配件。
- 保固期間內，調整準確度無需任何費用，但顧客須自送門市或泰菱公司處理，如需泰菱公司派員收送件，將會有快遞費用產生，並於寄回儀器時實到付款方式收取快遞費用。
- 過保件泰菱公司將酌收基本檢測費用，並視問題有權決定維修或給予更換良品。
- 維修或更換新品時，泰菱公司將不負責儀器內的記錄資料，也不保證維修處理後，儀器內會保留之前的記憶資料。
- 如顧客自行拆卸儀器，或自行更改儀器電路、規格，泰菱公司有權不維修。